

HardGas X4

Портативные газоанализаторы



Руководство пользователя

Содержание

1.Описание и работа прибора	6
1.1.Назначение	6
1.2.Область применения	6
1.3.Конструктивные особенности	7
1.4.Технические и метрологические характеристики	9
1.5.Сроки службы и гарантии изготовителя	11
1.6.Комплектация	13
1.7.Устройство и работа	13
1.8.Маркировка и пломбирование	20
1.9.Упаковка	21
1.10.Обеспечение взрывозащищенности	21
2.Меры безопасности	23
3.Использование по назначению	25
3.1.Указания по эксплуатации	25
3.2.Эксплуатационные ограничения	25
3.3.Подготовка к работе	25
3.4.Проверка работоспособности	26
3.5.Зарядка аккумуляторной батареи прибора	28
3.6.Введение в меню	30
3.7.Заводские настройки	35
3.8.Дополнительные настройки	36
3.9.Калибровка	36
3.10.Поиск и устранение неисправностей	39
4.Техническое обслуживание	40
5.Транспортирование и хранение	41
5.1.Транспортирование	41
5.2.Хранение	41
5.3.Консервация и перевод на хранение	42
6.Утилизация	43
6.1.Информация о содержании драгоценных металлов	43
6.2.Информация о ртутьсодержащих материалах и компонентах	43

7.Приложение	45
7.1.Приложение А	45

Перед началом работ, пожалуйста, прочтите данное руководство по эксплуатации (далее - РЭ)! Оно содержит важные указания и данные, соблюдение которых обеспечит правильное функционирование газоанализаторов HardGas X4 (далее - газоанализаторы) и обеспечит надежные результаты измерений.

Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с улучшением технических и потребительских качеств, вследствие чего в РЭ возможны незначительные расхождения между текстом, эксплуатационной документацией и изделием, не влияющие на качество, работоспособность, надежность и долговечность газоанализаторов.

Настоящее РЭ содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации газоанализаторов HardGas X4, предназначено для изучения газоанализаторов, их характеристик и правил эксплуатации с целью правильного обращения с ними при эксплуатации.

Газоанализаторы допущены к применению в Российской Федерации и включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений под регистрационным номером 91609-24.

Газоанализаторы соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 012/2011.

Перечень сокращений

ГА – газоанализатор;

ГС– газовая смесь;

ЛВЖ– легковоспламеняющиеся жидкость;

НКПР– нижний концентрационный предел распространения пламени;

ТКД – термокаталитический датчик (сенсор);

ЭХД – электрохимический датчик (сенсор);

ИКД – инфракрасный (оптический) датчик (сенсор);

ФИД – фотоионизационный датчик (сенсор);

ПГС– поверочная газовая смесь;

ПДК– предельно допустимая концентрация;

ПК– персональный компьютер;

ПО– программное обеспечение;

ПС– паспорт;

ПТБ– правила техники безопасности;

РЭ– руководство по эксплуатации;

ТО– техническое обслуживание.

1. Описание и работа прибора

1.1. Назначение

Портативный газоанализатор HardGas X4 (далее газоанализатор) — это контрольно-измерительное устройство, предназначенное для автоматического непрерывного измерения концентраций токсичных газов, горючих газов, кислорода и углекислого газа в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств промышленных объектов, а также выдачи сигнализации о достижении содержания определяемых компонентов установленных пороговых значений.

Тип газоанализаторов – портативные (индивидуальные) многоканальные (от 1 до 4 каналов).

Принципы действия газоанализаторов - электрохимический, термokatалитический, инфракрасный, фотоионизационный в зависимости от установленного сенсора.

Способ отбора пробы – диффузионный или принудительный за счет внешнего пробоотборного насоса. При работе во взрывоопасной зоне внешний пробоотборный насос должен иметь взрывозащищенное исполнение.

1.2. Область применения

1.2.1 Газоанализаторы предназначены для контроля содержания взрывоопасных веществ, вредных веществ и кислорода в воздухе производственных, административных, жилых помещений и открытых пространств.

Сфера применения газоанализаторов в соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» – «выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда».

1.2.2 Газоанализаторы являются взрывозащищенным оборудованием и предназначены для применения во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 категорий взрывоопасных смесей IIA, IIB, IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, а также подземные выработки шахт и рудников, в том числе опасные по газу и (или) пыли, согласно маркировке взрывозащиты.

1.3. Конструктивные особенности

1.3.1 Внешний вид

Внешний вид газоанализаторов представлен на рисунках 1 и 2.



Рисунок 1 – HardGas X4 вид спереди



Рисунок 2 – HardGas X4 вид сзади

1.3.2 Габаритные размеры

Габаритные размеры газоанализаторов представлены на рисунке 3. Все размеры указаны в миллиметрах.

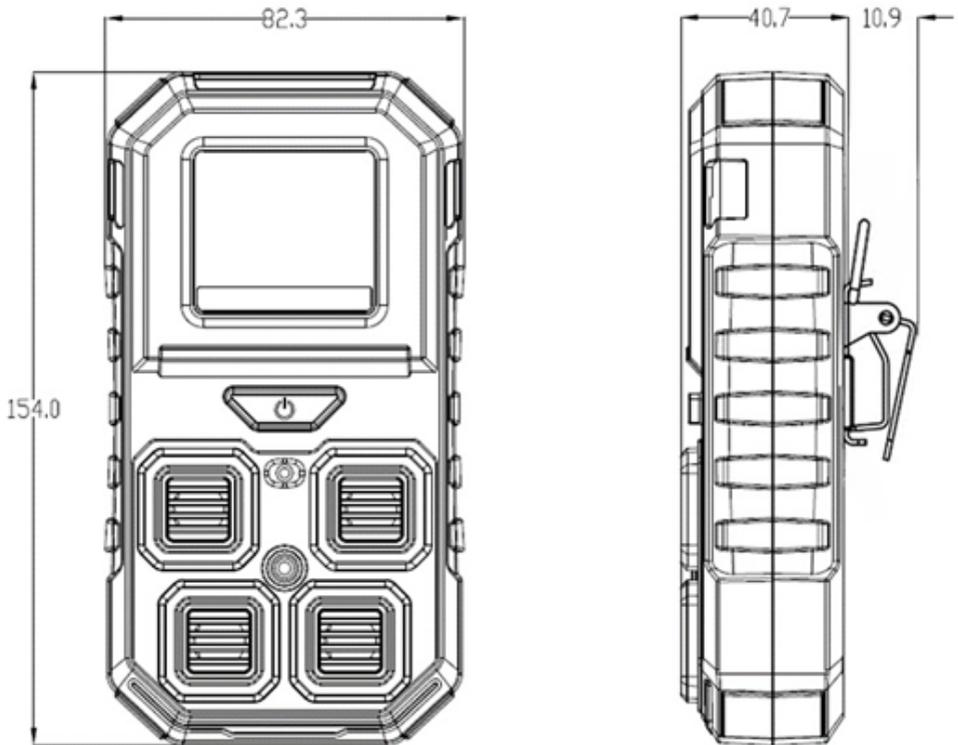


Рисунок 3 – Габаритные размеры HardGas X4.

1.3.3 Конструкция и элементы управления газоанализаторов

Конструктивно приборы выполнены в корпусе из ударопрочного пластика, обеспечивающего герметичность и устойчивость к падению. Внешняя конструкция и элементы управления показаны на Рисунке 4.

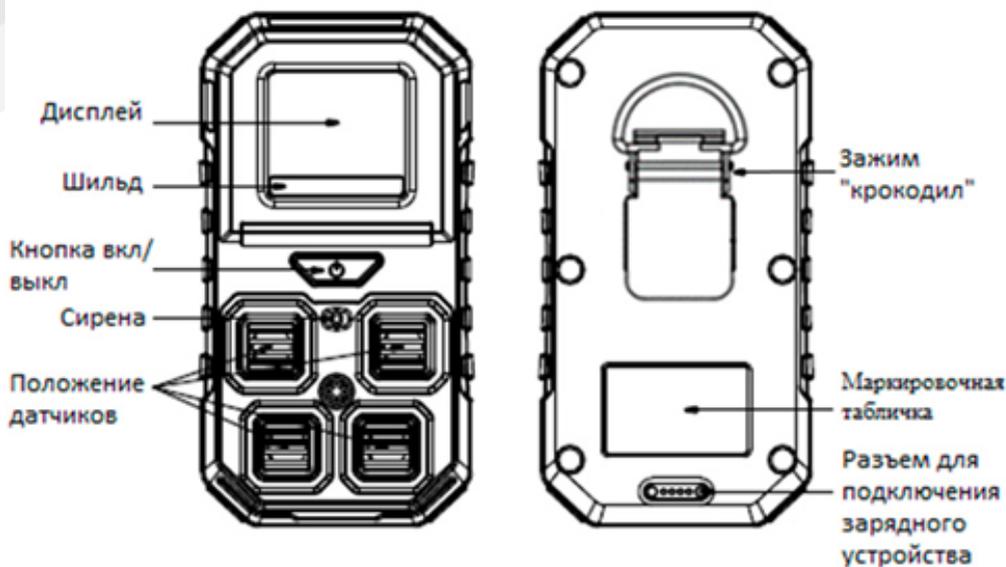


Рисунок 4 - Внешняя конструкция и элементы управления HardGas X4.

1.4. Технические и метрологические характеристики

1.4.1 Технические характеристики газоанализатора приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики газоанализатора.

Параметры электропитания	
Время работы от аккумуляторной батареи, ч, не менее	20
Время для полной зарядки аккумулятора, ч, не более	6

Емкость аккумулятора	4000 мАч
Напряжение питания	3,7 В
Мощность электромагнитного излучения газоанализатора, не более	25 мВт
Эксплуатационные характеристики	
Метод пробоотбора	- диффузионный - принудительный (с использованием внешнего пробоотборного насоса)
Тип устанавливаемых сенсоров	- инфракрасный - термокаталитический - электрохимический - фотоионизационный
Определяемые компоненты (в зависимости от установленного сенсора)	горючие газы (C1-C10), CO ₂ , O ₂ , H ₂ S, CO, NH ₃ , SO ₂ , H ₂ , NO, NO ₂ , HCl, HCN, HF, CH ₃ OH, PH ₃ , Cl ₂ , COCl ₂ , C ₂ H ₃ Cl, ЛОС (летучие органические соединения) на уровне ПДК
Количество контролируемых газовых компонентов	От 1 до 4
Средства сигнализации	-OLED дисплей -звуковая сирена -вибрация -яркие сигнальные светодиоды
Уровень звукового давления	95 дБ
Маркировка взрывозащиты	PO Ex ia I Ma X
Степень защиты оболочки	IP68 ¹⁾

Уровень защиты ПО	«высокий» согласно Р 50.2.077-2014
Передача информации на компьютер	Через порт для зарядки газоанализатора и USB-порт компьютера
Диапазон температуры окружающей среды	от - 45°C до + 50 °C
Диапазон атмосферного давления	от 70 до 130 кПа
Влажность (без образования конденсата)	от 5 до 95 %
Конструктивные параметры	
Габаритные размеры (с учетом клипсы)	154x82x41 мм
Масса с батареей, не более	400 грамм
¹⁾ Методика проведения испытаний по второй характеристической единице в соответствии с ГОСТ 14254-2015: погружение в резервуар с водой с уровнем воды над оболочкой 1,1 м выше нижней точки прибора, длительность испытаний - 35 минут.	

1.4.2 Метрологические характеристики

Метрологические характеристики указаны в приложении к Сертификату об утверждении типа средства измерений на газоанализаторы портативные HardGas.

1.5. Сроки службы и гарантии изготовителя

1.5.1 Изготовитель гарантирует соответствие Прибора требованиям технических условий ЕТЛС.413411.001 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Средний срок службы газоанализаторов – 15 лет.

1.5.2 Гарантийный срок эксплуатации на газоанализатор – 24 месяца со дня отгрузки прибора потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации сенсоров:

- инфракрасный – 24 месяца;
- термokatалитический – 12 месяцев;
- электрохимический – 12 месяцев;
- фотоионизационный – 12 месяцев;

Гарантийный срок не распространяется на элементы питания.

1.5.3 Гарантия сохраняется при условии выполнения норм технического обслуживания прибора, описанных в настоящем РЭ.

1.5.4 В течение гарантийного срока изготовитель обязуется устранять обнаруженные неисправности при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

1.5.5 К негарантийным случаям относятся:

1. механические повреждения газоанализатора, возникшие после исполнения поставщиком обязательств по поставке;
2. повреждения газоанализатора вследствие нарушения правил и условий эксплуатации, изложенных в РЭ и другой документации, передаваемой покупателю в комплекте с газоанализатором;
3. повреждения газоанализатора вследствие природных явлений и непреодолимых сил (удар молнии, пожар и пр.), несчастных случаев, а также несанкционированных действий третьих лиц;
4. самостоятельное вскрытие газоанализатора покупателем или третьими лицами без письменного разрешения производителя;

5. использование газоанализатора не по прямому назначению;
6. возникновение дефекта, вызванного изменением конструкции газоанализатора, подключение внешних устройств, не предусмотренных изготовителем, использование нестандартных зарядных устройств и аккумуляторной батареи;
7. возникновение дефекта, вызванного вследствие естественного износа частей, а также, корпусных элементов газоанализатора в случае превышения норм нормальной эксплуатации;
8. повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь газоанализатора посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и прочее.

1.6. Комплектация

Комплект поставки прибора приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Комплект поставки прибора.

Наименование	Количество
Газоанализатор портативный HardGas X4	1 шт.
Калибровочная крышка	1 шт.
Зарядное устройство (блок питания, провод)	1 шт.
Паспорт	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз. на партию по запросу

1.7. Устройство и работа

1.7.1 Принцип действия приборов:

- для измерения содержания взрывоопасных концентраций углеводородов в смеси с воздухом применяют термокаталитический сенсор, принцип действия которого основан на беспламенном окислении горючих компонентов газовой смеси на поверхности катализатора.
- для измерения содержания углеводородов и диоксида углерода в газоанализаторах применяются инфракрасные сенсоры, принцип действия которого основан на селективном поглощении молекулами определяемого компонента электромагнитного излучения и измерении интенсивности инфракрасного излучения после прохождения им среды, содержащей определяемый компонент.
- для измерения содержания кислорода и токсичных газов в газоанализаторах применяются электрохимические сенсоры, принцип измерения которых основан на потенциостатической амперометрии, заключающейся в измерении тока при электрохимическом окислении вещества на рабочем электроде электрохимической ячейки.
- для измерения предельно допустимых концентраций токсичных и взрывоопасных газов газоанализаторы применяют фотоионизационный сенсор, принцип измерения которого основан на измерении силы тока, вызванного ионизацией газов и паров, пропорциональной концентрации определяемого вещества.

1.7.2 Структурная схема газоанализатора показана на рисунке 5.

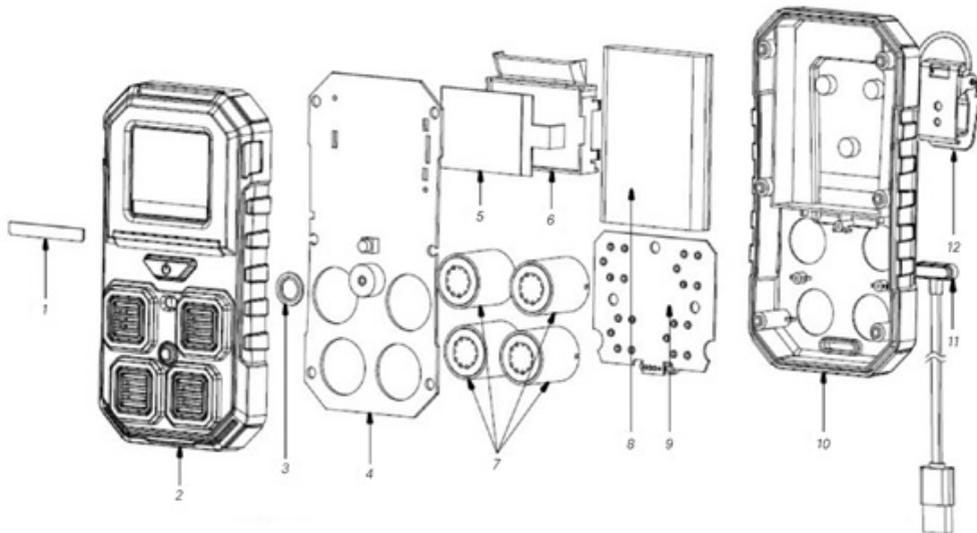


Рисунок 5 – Структурная схема газоанализатора.

1-шильд с названием; 2-лицевая панель; 3- уплотнительное кольцо;
4- основная плата; 5 – дисплей; 6 –держатель дисплея; 7- сенсорные
модули; 8- аккумулятор; 9- адаптерная пластина; 10- задняя крышка
корпуса; 11-зарядный кабель; 12- зажим для крепления;

1.7.3 Функциональные возможности:

- непрерывное измерение и цифровая индикация от одного до четырёх измеряемых газов;
- подача световой, звуковой и вибросигнализации при достижении содержания определяемого компонента порогов срабатывания «Порог 1» и «Порог 2»;
- полнофункциональная самодиагностика при включении и во время работы: датчик, заряд батареи, электроника и функция сигнализации;

- возможность установки среднесменного (8 часов) значения концентрации (TWA) и средней допустимой концентрации за короткий промежуток времени (STEL) с выдачей сигнализации о их превышении;
- запись, хранение и последующее отображение 500 случаев аварийных срабатываний;
- передача результатов измерений на ПК через интерфейс USB;
- функция защиты паролем сервисной и метрологической части настройки газоанализатора;
- функция автоматического возврата в режим измерения, при невыполнении действий в течении 30 секунд;
- пользовательская настройка звука сигнализации и предупреждения о неисправности;
- пользовательская настройка порогов срабатывания сигнализации «ПОРОГ 1» и «ПОРОГ 2» и неисправности;
- отдельное меню калибровки прибора с помощью одной кнопки;
- функция автоматической калибровки нуля;
- функция защиты от случайного включения и выключения;
- отображение заряда батареи в реальном времени, предупреждение о низком заряде;
- функция автоматического измерения температуры окружающей среды.
- опциональная функция передачи данных (частота 2,4 ГГц или 868 МГц по протоколам Mxair, LoRaWAN, LoRa, E-WIRE);
- опциональная функция Bluetooth;
- опциональная функция определения местоположения (GPS, ГЛОНАСС).

1.7.4 Описание дисплея

При включении прибора на дисплее отображаются:

1. Наименование модели
2. Запуск тестирования
3. Информация о тестировании дисплея (мерцание экрана – 2 раза)
4. Информация о тестировании памяти
5. Информация о тестировании звукового сигнала (короткий сигнал – 3 раза)
6. Информация о тестировании светодиодов (мигание – зеленый, желтый, красный)
7. Информация о тестировании вибрации (короткая вибрация – 3 раза)
8. Информация о тестировании каналов
9. Параметры сенсоров
 - a. контролируемый газ
 - b. значение калибровки
 - c. диапазон показаний
 - d. Порог 1
 - e. Порог 2
10. Оставшееся количество дней до ежегодной калибровки
11. Версия ПО прибора.

После прогрева газоанализатора, дисплей переходит в «основной режим работы» (Рисунок 6).



Рисунок 6 – Дисплей HardGas X4 в «основном режиме работы»

1.7.5 Описание кнопок

Газоанализатор имеет только одну кнопку на передней панели прибора. Её назначение описано в таблице 3.

Таблица 3 – Описание кнопок.

	Включение питания	нажмите и удержите кнопку в течение 3 секунд, затем отпустите ее, когда устройство включится
	Работа в режиме измерения	двойное быстрое нажатие кнопки - вход в меню
	В режиме меню	одно нажатие кнопки - перемещение вниз/ вверх/(редактирование) добавление единицы к значению
		двойное нажатие кнопки - подтверждение/(редактирование) перемещение курсора назад на одну единицу
В состоянии тревоги	длительное нажатие кнопки - возврат/отмена/(редактирование) подтверждение	
	В состоянии тревоги	одно нажатие кнопки - выключения вибрации и звукового сигнала

1.7.6 Режимы работы меню прибора:

- «основной режим работы» - режим отображения измеренных данных;
- «основной режим работы» в режиме энергосбережения – в этом режиме экран потушен;
- «режим основного меню»;
- «режим меню системных настроек и калибровки» – вход через ввод пароля.

1.7.7 Сигнализация

Сигнализация газоанализатора описана в таблице 4.

Таблица 4 – Световая, звуковая и вибросигнализация.

Событие	Световая сигнализация	Звуковая сигнализация	Вибросигнал
Стандартная сигнализация			
Включение прибора	Три короткие вспышки: красная, зеленая и желтая	3 кратких сигнала	3 кратких сигнала
Выключение прибора	-	Длинный разовый сигнал	-
Нажатие кнопки	-	Краткий разовый сигнал (можно отключить в меню)	-
Разряд батареи	Частые повторяющиеся зеленые вспышки светодиодов	Краткие до полного выключения	-
Ошибка	Частые повторяющиеся желтые вспышки светодиодов	Частые повторяющиеся сигналы	Частые повторяющиеся сигналы

Основной режим измерений	Редкие повторяющиеся зеленые вспышки светодиодов	-	-
Предупреждающая сигнализация			
Превышен ПОРОГ1	Редкие повторяющиеся красные вспышки светодиодов	Редкие повторяющиеся сигналы	Редкие повторяющиеся сигналы
Превышен ПОРОГ 2	Частые повторяющиеся красные вспышки светодиодов	Частые повторяющиеся сигналы	Частые повторяющиеся сигналы

1.8. Маркировка и пломбирование

1.8.1 Маркировка HardGas X4 содержит:

- наименование предприятия - изготовителя;
- наименование и модель прибора;
- определяемые газы;
- заводской номер прибора;
- номер ТУ;
- название органа сертификации и номер сертификата.
- маркировка взрывозащиты;
- код IP;
- диапазон рабочих температур;

- регистрационный номер сертификата соответствия;
- страна производителя;
- рекомендации по использованию.

1.8.2 Пломбирование

Защита от несанкционированного доступа к настройкам газоанализаторов осуществляется посредством введения секретного кода (пароля). Дополнительных мер защиты в виде пломб, наклеек не требуется.

1.9. Упаковка

Газоанализатор упаковывается в транспортную тару завода изготовителя с соблюдением требований ГОСТ 23170-78. Сопроводительная документация прилагается.

Срок защиты от переконсервации – 1 год.

1.10. Обеспечение взрывозащищенности

Газоанализаторы с маркировкой взрывозащиты PO Ex ia I Ma X соответствуют группе I по ГОСТ 31610.11-2014 – рудничное взрывозащищенное электрооборудование, предназначенное для применения в подземных выработках шахт, рудников и в их наземных строениях, опасных по рудничному газу и/или горючей пыли.

Вид взрывозащиты газоанализаторов – искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11-2014.

Искробезопасные электрические цепи газоанализаторов относятся к уровню «ia».

Собственные значения индуктивности и емкости газоанализаторов с маркировкой взрывозащиты PO Ex ia I Ma X, а также входные токи I_i и напряжения U_i не должны превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5 Параметры искрозащиты газоанализаторов с видом взрывозащиты PO Ex ia I Ma X.

Наименование и модель изделия	Ui (В)	Ii (мА)	Ci (мкФ)	Li (мГн)	Pi, (Вт)
Газоанализатор HardGas X4	3,7	4000	0	0	2

Электрические элементы защищены от механических и климатических воздействий оболочкой со степенью защиты IP68. Механическая прочность оболочки соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования с высокой опасностью механических повреждений.

Для предотвращения заряда конденсаторов газоанализатора до опасных значений (при выходе из строя внутреннего стабилизатора напряжений) цепи питания шунтированы стабилитронами, расположенными в неразборной оболочке газоанализатора, ток по стабилитронам в аварийном режиме не превышает 2/3 номинального значения.

Температура нагрева элементов и соединений электрических цепей газоанализатора с маркировкой взрывозащиты PO Ex ia I Ma X не должна превышать 150 °С при максимальной температуре окружающей среды.

Фрикционная искробезопасность газоанализатора с маркировками взрывозащиты PO Ex ia I Ma X, обеспечивается отсутствием деталей оболочек из легких сплавов.

Электростатическая искробезопасность газоанализатора обеспечивается применением материала с поверхностным электрическим сопротивлением не более 109 Ом

Эксплуатация газоанализаторов с маркировкой взрывозащиты PO Ex ia I Ma X должна проводиться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах» и требованиями руководства по эксплуатации.

Специальные условия

Знак «X» в маркировке взрывозащиты газоанализаторов указывает на специальные условия безопасного применения, заключающиеся в следующем:

- зарядку газоанализаторов осуществляют вне взрывоопасной зоны. При перемещении оборудования обратно во взрывоопасную зону необходимо убедиться, что температура ниже промаркированного температурного класса.

2. Меры безопасности

1. К работе с газоанализатором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Запрещается эксплуатация газоанализатора с поврежденными элементами, корпусом и прочими неисправностями.
2. Прибор следует оберегать от механических ударов. Запрещается механическое воздействие на сенсоры. Запрещается надавливать, протыкать сенсоры любыми предметами. Запрещается воздействие струей воздуха под давлением более 0,15 МПа на сенсор прибора при очистке корпуса от загрязнений.
3. Запрещается несанкционированная замена компонентов прибора.
4. Запрещается проводить зарядку прибора, замену сенсоров и вскрывать прибор во взрывоопасных зонах.
5. Калибровку прибора с помощью газовых смесей следует проводить не реже 1 раза через каждые 6 месяцев эксплуатации, а также в следующих случаях:
 - после замены датчиков;
 - перед проведением периодической поверки газоанализаторов;
 - если газоанализатор подвергался физическому удару;
 - если газоанализатор подвергался длительному воздействию вредных веществ;
 - если анализируемая среда содержит соединения, которые могут снизить чувствительность ТХД (каталитические яды и агрессивные вещества);
 - в случае возникновения сомнений в достоверности показаний газоанализаторов.

6. Ремонтировать прибор разрешено только персоналу предприятия изготовителя или лицам, уполномоченным предприятием-изготовителем для проведения ремонтных работ.

3. Использование по назначению

3.1. Указания по эксплуатации

Эксплуатировать HardGas X4 необходимо в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.



Внимание: Производитель не несет ответственности за выход из строя прибора или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования прибора.

3.2. Эксплуатационные ограничения

Условия эксплуатации приведены в таблице 1 настоящего РЭ.

3.3. Подготовка к работе

3.3.1 Перед первой эксплуатацией прибора рекомендуется выполнить следующие действия:

- проверка комплектности;
- изучение эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт и др.)
- проведение внешнего осмотра газоанализатора (сличить заводской номер на корпусе прибора и в эксплуатационных документах, проверить целостность корпуса, убедиться в отсутствии механических повреждений, проверить наличие всех крепежных элементов).

3.3.2 Если прибор хранился при отрицательных температурах, то во избежание образования конденсата на печатных платах прибора, его требуется выдержать в нормальных условиях не менее 24 часов.

3.4. Проверка работоспособности

3.4.1 На чистом воздухе включить прибор, нажать и удерживать кнопку включения в течение 3 секунд, на экране отобразится окно «запуск устройства» (рисунок 7). После того как индикатор хода запуска достигнет 100%, отпустите кнопку, и на экране появится название газоанализатора (рисунок 7А).

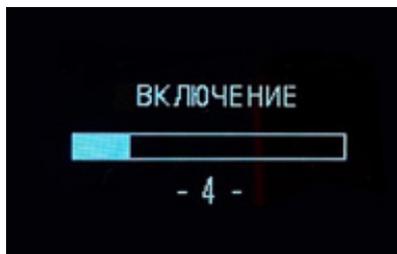


Рисунок 7



Рисунок 7А

! Примечание: Понятие «чистый воздух» - атмосферный воздух, в котором заведомо отсутствуют горючие газы, а также влияющие и загрязняющие вещества.

3.4.2 После включения, прибор перейдет в режим самотестирования (рисунок 7Б).

Тестирование включает в себя:

- проверку экрана дисплея,
- проверку памяти,
- проверку звукового, светового и вибросигнала,
- проверку сенсора.

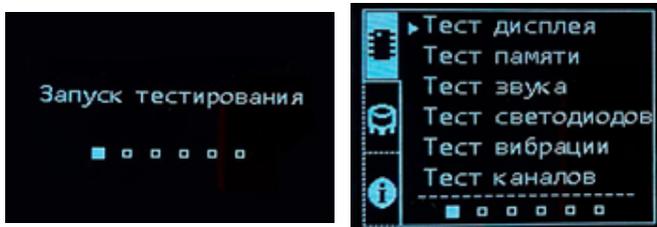


Рисунок 7Б

По окончании самопроверки на дисплее отобразиться информация о параметрах каждого датчика (рисунок 7В).

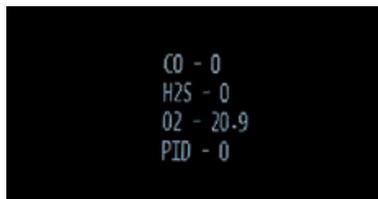


Рисунок 7В

3.4.3 Далее, если нет никаких ошибок, прибор переходит к прогреву (рисунок 7Г).

При возникновении ошибки, войдите в прогрев после их устранения.

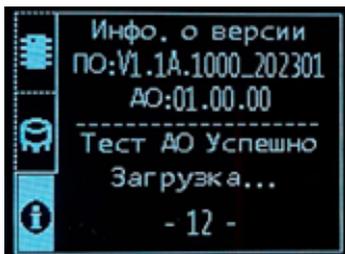


Рисунок 7Г

После предварительного прогрева прибор переходит в «основной режим измерения» (рисунок 7Д).

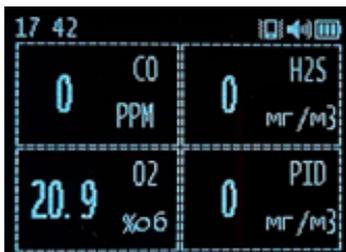


Рисунок 7Д

3.4.4 Для выключения прибора необходимо в «основном режиме измерения» нажать и удерживать кнопку в течение 3 секунд, на экране появится индикатор процесса выключения (рисунок 8). Когда индикатор достигнет 100%, устройство автоматически выключится. Если в процессе выключения отпустить кнопку, прибор автоматически вернется в «основном режиме измерения»

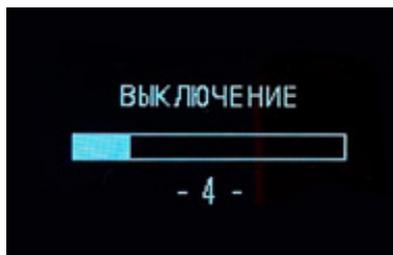


Рисунок 8

3.5. Зарядка аккумуляторной батареи прибора

3.5.1 Заряд аккумуляторной батареи прибора должен производиться вне взрывоопасной зоны. Газоанализатор оснащен магнитный механизм для зарядки

(рисунок 9). Поднесите конец зарядного провода к разъему зарядки на задней части газоанализатора до примагничивания, зарядка начнется автоматически.

3.5.2 В нормальных условиях при комнатной температуре зарядное устройство может произвести зарядку полностью разряженной аккумуляторной батареи не менее чем за 4 (четыре) часа.

3.5.3 Перед зарядкой очень холодных или очень горячих приборов (при температуре вне диапазона условий эксплуатации), нужно выдержать газоанализаторы в течение часа при комнатной температуре.

3.5.4 Зарядное устройство питается от сети напряжения переменного тока 220 В. Разрешается использовать только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.

3.5.5 В процессе заряда аккумуляторной батареи на дисплее отображается статус зарядки, а индикатор батареи показывает уровень заряда, при достижении полного уровня заряда, индикатор зарядного устройства меняется с красного на зеленый, указывая на то, что зарядка завершена, после чего зарядное устройство можно отключить от сети.

3.5.6 В случае разряда аккумуляторной батареи прибор раз в минуту будет подавать звуковой сигнал, значок батареи будет мигать, световая сигнализация начинает моргать чаще. Если газоанализатор не подключить к зарядному устройству он выключится через 20 минут.

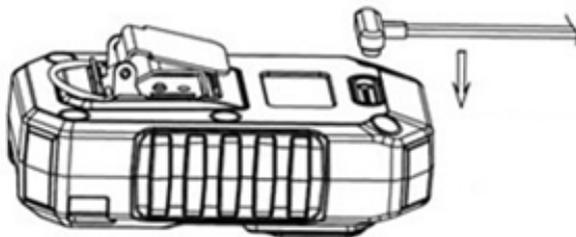


Рисунок 9 - Подключение зарядного устройства.

3.6. Введение в меню

3.6.1. Вход в меню

В «основном режиме измерения» двойным нажатием кнопки перейдите в меню (рисунок 10). Главное меню включает в себя основные пункты:

- архив записей,
- настройка каналов,
- настройка прибора,
- информация о приборе,
- дополнительные настройки

Переход к выбранному пункту осуществляется однократным нажатием кнопки, переход между пунктами – двойным нажатием кнопки. Для возврата к «основному режиму измерения» нажмите и удержите кнопку.

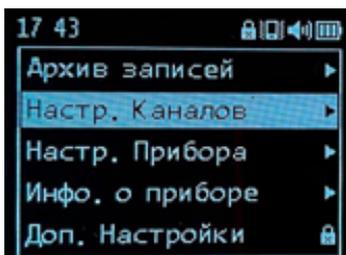


Рисунок 10 - Главное меню.

3.6.2 Тестирование системы

«Тестирование системы» подразумевает проведение проверки работы устройства. После проведения тестирования прибор автоматически перейдет в «основной режим измерения». Подробнее об особенностях смотрите в разделе 3.4.2.

3.6.3 Архив записей

«Архив записей» позволяет просматривать записи о сигнализации (рисунок 11).

Он включает четыре дополнительных пункта:

- запись тревог,
- записи операций,
- запустить операцию,
- записи о калибровках.

Одно нажатие кнопки - перемещение курсора, двойное нажатие кнопки - вход в соответствующий пункт меню для просмотра информации.

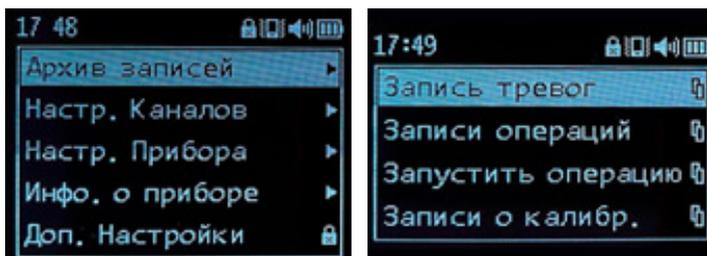


Рисунок 11 - Архив записей.

3.6.4 Параметры системы

«Параметры системы» используется для установки некоторых параметров, необходимых для работы оборудования.

Включает в себя дополнительные пункты (рисунок 12):

- дата и время,
- язык,
- автоматический сон,

- яркость,
- звук кнопок,
- сигнал тревоги,
- задержка тревоги.

Одно нажатие кнопки - перемещение курсора, двойное нажатие кнопки - вход в соответствующий пункт меню для просмотра информации.

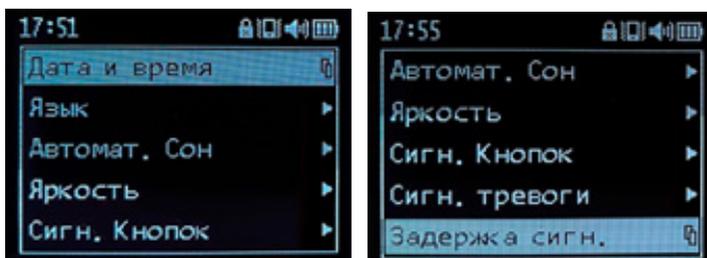


Рисунок 12

3.6.5 Параметры канала

«Параметры канала» служат для настройки и калибровки используемого в данный момент сенсора (рисунок 13). В меню содержится список газов, в соответствии сенсoram, подключенным к устройству.

Одно нажатие кнопки - перемещение курсора, двойное нажатие кнопки - вход в соответствующий пункт меню для просмотра информации.

«Параметры канала» включает в себя дополнительные пункты (рисунок 13):

- Порог 1,
- Гистерезис П_1,
- Порог 2,

- Гистерезис П₂,

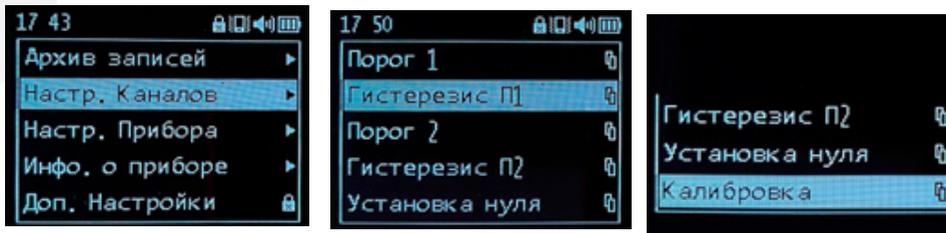


Рисунок 13

3.6.6 Информация об устройстве

«Информация об устройстве» используется для просмотра информации о состоянии устройства, выполнения тестирования оборудования и восстановления заводских настроек

Одно нажатие кнопки - перемещение курсора, двойное нажатие кнопки - вход в соответствующий пункт меню для просмотра информации.

«Информация об устройстве» включает (Рисунок 14):

- данные калибровки;
- состояние прибора;
- тест прибора;
- сброс к заводским настройкам.

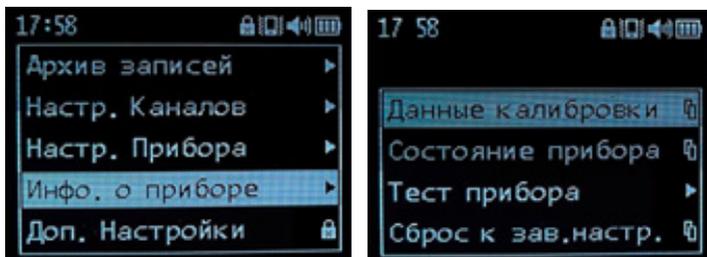


Рисунок 14

3.6.7 Состояние прибора

«Состояние прибора» отображает статус работы и информацию об аппаратном обеспечении оборудования (рисунок 15).

«Состояние прибора» содержит четыре страницы отображения:

- информацию о сенсоре,
- статус сенсора,
- статус аналогового количества и информацию об оборудовании.

Четыре страницы отображения содержат:

- тип сенсора, к которому в данный момент осуществляется доступ,
- статус сенсора каждого канала информацию об аналоговом количестве внутри устройства и
- информацию об аппаратном обеспечении устройства.

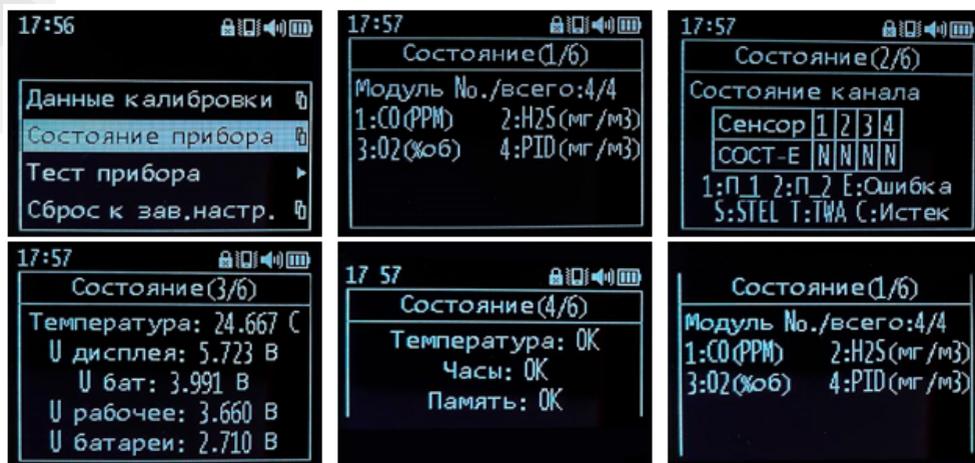


Рисунок 15

3.7. Заводские настройки

Восстановление заводских настроек означает возврат настроек газоанализатора к заводским параметрам (рисунок 16).

⚠ Будьте осторожны! В случае неосторожного применения настроек, параметры, измененные после выхода прибора из производства, будут потеряны.

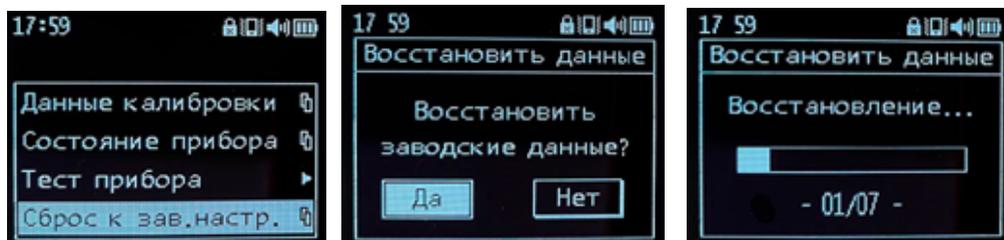


Рисунок 16 - Восстановление заводских настроек.

3.8. Дополнительные настройки

Меню дополнительных функций используется для оптимизации и настройки оборудования. Вход в него запрещен пользователю, не имеющему профессиональных навыков. Для входа в расширенное меню требуется пароль.

3.9. Калибровка

3.9.1 Рекомендуется не реже одного раза в 6 месяцев проводить корректировку показаний с помощью поверочных газовых смесей (далее ПГС).

3.9.2 Для проведения калибровки необходимы средства измерения и инструменты, указанные в таблице 6.

Таблица 6 - Средства измерения необходимые при градуировке.

№	Наименование
1	ПГС согласно методике поверки
2	Редуктор с фиксированным расходом $0,5 \pm 0,2$ л/мин или редуктор и ротаметр, позволяющие установить расход $0,5 \pm 0,2$ л/мин.
3	Насадка для градуировки, позволяющая подавать газовые смеси непосредственно на измерительную часть прибора. Поставляется в комплекте с прибором.

3.9.3 При эксплуатации баллонов с поверочными газовыми смесями необходимо выполнять требования, предусмотренные «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ-10-115-03).

3.9.4. Порядок действий при калибровке прибора:

Собрать схему калибровки в соответствии с рисунком 17:

1 – Баллон с ПГС

2 – Редуктор

3 – Ротаметр

4 – Газоанализатор

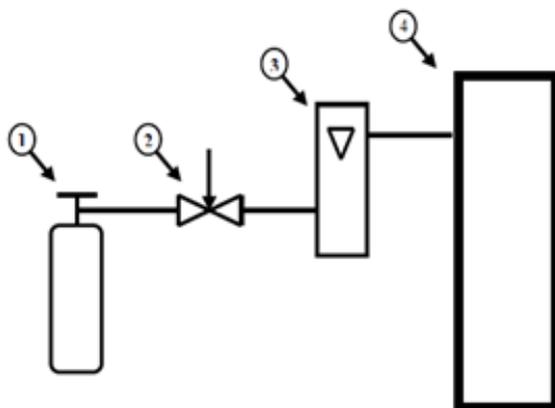


Рисунок 17 - Схема калибровки прибора.

3.9.5. Вход в меню калибровки

В меню «Параметры канала» (подробнее раздел 3.6.5) двойным нажатием кнопки выберете пункт «Калибровка». Далее установите необходимое значение концентрации калибровочного газа (выбранная цифра мигает). После выбора значения, нажмите и удержите кнопку для установки значения (как показано на рисунке 18). После подтверждения установки концентрации газа, на дисплее отобразится обратный отсчет. Во время обратного отсчета нажмите кнопку, чтобы отменить операцию калибровки. По окончании обратного отсчета, на экране отобразиться статус «Успешно».



Рисунок 18 - Вход в меню калибровки.

3.9.6 Калибровка «нуля»

Калибровка «нуля» может внести поправки в работу газоанализатора, для получения более точных результатов. Однако, по сравнению с калибровкой, она не может исправить отклонение чувствительности, вызванное длительным использованием. Калибровка «нуля» может использоваться только тогда, когда нет возможности провести калибровку.

Метод калибровки нуля: после того как газоанализатор стабильно проработает 10 минут, поместите его в чистую воздушную среду. Если измеряемым газом является кислород, то установку нуля необходимо проводить в среде чистого азота. Войдите в меню «параметры канала», выберите соответствующий датчик, и перейдите к «калибровке нуля». Нажмите и удержите кнопку для подтверждения (рисунок 19). Далее на экране появится обратный отсчет и статус «датчик калибруется». После успешного завершения на экране появится статус «калибровка датчика выполнена успешно».

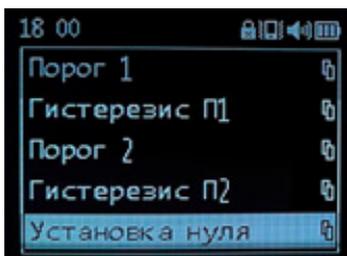


Рисунок 19

3.10. Поиск и устранение неисправностей

Прибор оборудован системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить неисправности. Если прибор функционирует неправильно или не работает, следует проверить возможные неисправности, приведенные в таблице 7.

Таблица 7 – Возможные неисправности.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
При включении питания дисплей прибора погашен	Разряжена аккумуляторная батарея прибора	Зарядить батарею
Газоанализатор в режиме измерения показывает заведомо некорректные показания или есть подозрение на высокую погрешность	Требуется калибровка сенсора прибора	Провести калибровку в соответствии с РЭ. Если неисправность не устранится - обратиться в сервисный центр производителя.
При включенном питании дисплей прибора отображает какую-либо ошибку либо сигнализация прибора работает некорректно	Неисправность сенсорного модуля либо электроники прибора.	Обратиться в сервисный центр производителя.

4. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание (ТО) проводится с целью обеспечения нормальной работы газоанализатора в течение его срока эксплуатации. ТО должно проводиться подготовленными лицами, знающими правила техники безопасности при работе с электроустановками и изучившими настоящее РЭ.

ТО включает в себя:

- осмотр внешнего состояния прибора;
- замена сенсорных модулей;
- проверка конструктивных элементов на наличие механических повреждений.

Периодичность проведения ТО - не реже 1 раза в год.

ТО проводить вне взрывоопасных зон помещений!

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование

5.1.1 Транспортирование газоанализатора в упаковке предприятия-изготовителя допускается производиться авиа, железнодорожным, водным, автомобильным или иным видами транспорта в закрытых транспортных средствах, а также в герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

5.1.2 Прибор в процессе транспортировки в транспортной таре завода - изготовителя сохраняют свои характеристики после воздействия на них следующих климатических факторов:

- температура окружающего воздуха: от -60°C до $+60^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха: от 0% до 100% без конденсации.

5.1.3 Прибор в транспортной таре сохраняет свои характеристики после воздействия на них следующих механических факторов:

- синусоидальная вибрация (группа исполнения F2 ГОСТ Р 52931-2008);
- единичные удары с ускорением до 30 g. 5.1.4

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, приборы в упаковке не должны подвергаться резким ударам, воздействию атмосферных осадков, растворителей, прочих агрессивных жидкостей и паров.

5.2. Хранение

5.2.1 Прибор в упаковке предприятия-изготовителя рекомендуется хранить на складах поставщика и потребителя в условиях хранения не ниже 3 по ГОСТ 15150-69. При хранении прибор и упаковку следует оберегать от попадания воды, а также воздействия растворителей и прочих агрессивных жидкостей и паров.

5.2.2 По истечении срока защиты без переконсервации (1 год) приборы должны быть переконсервированы.

5.3. Консервация и перевод на хранение

5.3.1 Консервация выполняется перед выводом прибора из эксплуатации на длительное время.

5.3.2 Порядок консервации:

1. Очистить поверхности прибора от внешних загрязнений влажной ветошью;
2. Просушить корпус прибора;
3. Выключить прибор;
4. Поместить прибор в упаковочную тару.

6. Утилизация

Запрещается утилизировать использованные литиевые элементы питания как бытовые отходы.

Разборка аккумулятора и его утилизация сжиганием запрещены!

Не утилизируйте аккумулятор вместе с другими твердыми бытовыми отходами. И использованный аккумулятор подлежит утилизации сертифицированным переработчиком или сборщиком опасных материалов.

6.1. Информация о содержании драгоценных металлов

Газоанализаторы серии HardGas независимо от модели и типа установленного газового сенсора не содержат драгоценных металлов.

6.2. Информация о ртутисодержащих материалах и компонентах

Портативный газоанализатор серии HardGas независимо от модели и типа установленного газового сенсора не содержит ртуть и/или ртутисодержащих компонентов.

Модели портативных газоанализаторов HardGas в составе с установленными инфракрасными, термокаталитическими и фотоионизационными сенсорами не содержат вредных, токсичных, самовоспламеняющихся, канцерогенных и иных опасных для окружающей среды и здоровья человека веществ и компонентов. Данные модификации газоанализаторов относятся к V классу опасности отходов (практически не опасные отходы) и могут быть переданы на утилизацию без дополнительной подготовки.

Модификации портативных газоанализаторов HardGas в составе с электрохимическими газовыми сенсорами содержат в своём составе кислоты и/или свинец. Рекомендуется перед передачей на утилизацию произвести удаление электрохимического газового сенсора. После удаления электрохимического газового сенсора прибор относится к V классу опасности отходов (практически неопасные отходы).

Снятые электрохимические сенсоры содержат в своём составе кислоты и/или свинец и должны быть утилизированы согласно требованиям производителей сенсоров или согласно требованиям обращения с отходами III класса опасности отходов (умеренно опасные), если не указано иное.

7. Приложение

7.1. Приложение А

Таблица 8 - Предустановленные пороги срабатывания газоанализатора.

Определяемый компонент	Диапазон измерений	Нижний порог	Верхний порог	Единица измерения
Термокаталитические датчики (ТКД)				
Метан CH_4	от 0 до 2,20	0,44	0,88	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Сумма углеводородов $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ (поверочный компонент: CH_4)	от 0 до 2,20	0,44	0,88	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Сумма углеводородов $\text{C}_1\text{-C}_{10}$ (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 0,85	0,17	0,34	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Этилен C_2H_4 (поверочный компонент: CH_4)	от 0 до 1,15	0,23	0,46	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Пропан C_3H_8	от 0 до 0,85	0,17	0,34	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
н-бутан C_4H_{10} (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 0,70	0,14	0,28	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
н-пентан C_5H_{12} (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 0,55	0,11	0,22	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
н-гексан C_6H_{14}	от 0 до 0,50	0,10	0,20	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР

н-гептан C ₇ H ₁₆ (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 0,43	0,09	0,18	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
н-октан C ₈ H ₁₈ (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 0,40	0,08	0,16	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
1-бутен C ₄ H ₈ (поверочный компонент: C ₃ H ₈)	от 0 до 0,80	0,16	0,32	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
2-метилпропан (изобутан) i-C ₄ H ₁₀ (поверочный компонент: C ₃ H ₈)	от 0 до 0,65	0,13	0,26	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Метилацетат C ₃ H ₆ O ₂	от 0 до 1,55	0,31	0,62	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
2-метокси-2-метилпропан (метилтретбутиловый эфир) tert-C ₅ H ₁₂ O (поверочный компонент: C ₃ H ₈)	от 0 до 0,80	0,16	0,32	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
1-бутанол C ₄ H ₉ OH (поверочный компонент: C ₃ H ₈)	от 0 до 0,70	0,14	0,28	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Циклопентан C ₅ H ₁₀ (поверочный компонент: C ₃ H ₈)	от 0 до 0,70	0,14	0,28	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Циклогексан C ₆ H ₁₂ (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 0,50	0,10	0,20	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Нонан C ₉ H ₂₀ (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 0,35	0,07	0,14	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР

Декан $C_{10}H_{22}$ (поверочный компонент: C_6H_{14})	от 0 до 0,35	0,07	0,14	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Этан C_2H_6 (поверочный компонент: CH_4)	от 0 до 1,20	0,24	0,48	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Пары нефтепродуктов (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Метанол CH_3OH (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 3,00	0,60	1,20	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Бензол C_6H_6 (поверочный компонент: C_6H_{14})	от 0 до 0,60	0,12	0,24	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Пропилен (пропен) C_3H_6 (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 1,00	0,20	0,40	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
2-пропанол (ацетон) C_3H_8O (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 1,25	0,25	0,50	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Водород H_2	от 0 до 2,00	0,40	0,80	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
2-метилпропен (изобутилен) $i-C_4H_8$ (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 0,80	0,16	0,32	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
2-метил-1,3-бутадиен (изопрен) C_5H_8 (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 0,85	0,17	0,34	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР

Ацетилен C_2H_2 (поверочный компонент: C_6H_{14})	от 0 до 1,15	0,23	0,46	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
1,3-бутадиен (дивинил) C_4H_6 (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 0,70	0,14	0,28	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Метилбензол (толуол) C_7H_8 (поверочный компонент: C_6H_{14})	от 0 до 0,50	0,10	0,20	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Этилбензол C_8H_{10} (поверочный компонент: C_6H_{14})	от 0 до 0,40	0,08	0,16	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Этилацетат $C_4H_8O_2$ (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 1,00	0,20	0,40	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Этиленоксид C_2H_4O (поверочный компонент: CH_4)	от 0 до 1,30	0,26	0,52	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Бутилацетат $C_6H_{12}O_2$ (поверочный компонент: C_6H_{14})	от 0 до 0,60	0,12	0,24	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Циклопропан C_3H_6 (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 1,20	0,24	0,48	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Диметилвый эфир C_2H_6O (поверочный компонент: CH_4)	от 0 до 1,35	0,27	0,54	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Диэтиловый эфир $C_4H_{10}O$ (поверочный компонент: C_3H_8)	от 0 до 0,85	0,17	0,34	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР

Этанол C ₂ H ₅ OH (поверочный компонент: CH ₄)	от 0 до 1,55	0,31	0,62	% об.д.
	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Бензин (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Дизельное топливо (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Бензин авиационный (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Уайт-спирит (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 50	10	20	% НКПР
Электрохимические датчики (ЭХД)				
Кислород O ₂	от 0 до 25,0	19,5	23,5	% об.д.
Кислород O ₂	от 0 до 30,0	19,5	23,5	% об.д.
Сероводород H ₂ S	от 0 до 100	7	14	млн ⁻¹
	от 0 до 142	10	20	мг/м ³
Сероводород H ₂ S	от 0 до 500	7	14	млн ⁻¹
	от 0 до 708	10	20	мг/м ³
Сероводород H ₂ S	от 0 до 1000	7	14	млн ⁻¹
	от 0 до 1420	10	20	мг/м ³
Оксид углерода CO	от 0 до 500	17	85	млн ⁻¹
	от 0 до 582	20	100	мг/м ³
Оксид углерода CO	от 0 до 1000	17	85	млн ⁻¹
	от 0 до 1164	20	100	мг/м ³

Оксид углерода CO	от 0 до 2000	17	85	млн ⁻¹
	от 0 до 2329	20	100	мг/м ³
Аммиак NH ₃	от 0 до 100	28	56	млн ⁻¹
	от 0 до 71	20	40	мг/м ³
Аммиак NH ₃	от 0 до 1000	28	56	млн ⁻¹
	от 0 до 708	20	40	мг/м ³
Диоксид серы SO ₂	от 0 до 20	4	8	млн ⁻¹
	от 0 до 53	10	20	мг/м ³
Диоксид серы SO ₂	от 0 до 50	4	8	млн ⁻¹
	от 0 до 133	10	20	мг/м ³
Диоксид серы SO ₂	от 0 до 100	4	8	млн ⁻¹
	от 0 до 266	10	20	мг/м ³
Водород H ₂	от 0 до 1000	80	200	млн ⁻¹
	от 0 до 84	7	17	мг/м ³
Водород H ₂	от 0 до 2000	80	200	млн ⁻¹
	от 0 до 168	7	17	мг/м ³
Оксид азота NO	от 0 до 250	4	16	млн ⁻¹
	от 0 до 312	5	20	мг/м ³
Диоксид азота NO ₂	от 0 до 20	1	5	млн ⁻¹
	от 0 до 38	2	10	мг/м ³
Диоксид азота NO ₂	от 0 до 150	1	5	млн ⁻¹
	от 0 до 287	2	10	мг/м ³

Хлористый водород HCl	от 0 до 20	3	16	млн ⁻¹
	от 0 до 30	5	25	мг/м ³
Цианистый водород HCN	от 0 до 20	2	9	млн ⁻¹
	от 0 до 23	2	10	мг/м ³
Фтористый водород HF	от 0 до 10	1	5	млн ⁻¹
	от 0 до 8	1	5	мг/м ³
Фтористый водород HF	от 0 до 20	1	5	млн ⁻¹
	от 0 до 17	1	5	мг/м ³
Метанол CH ₃ OH	от 0 до 100	4	11	млн ⁻¹
	от 0 до 133	5	15	мг/м ³
Фосфин PH ₃	от 0 до 10	1	3	млн ⁻¹
	от 0 до 14	1	3	мг/м ³
Фосфин PH ₃	от 0 до 20	1	3	млн ⁻¹
	от 0 до 28	1	3	мг/м ³
Фосген COCl ₂	от 0 до 20	1	2	млн ⁻¹
	от 0 до 82	1	3	мг/м ³
Хлор Cl ₂	от 0 до 20	1	2	млн ⁻¹
	от 0 до 60	1	5	мг/м ³
Хлор Cl ₂	от 0 до 100	1	2	млн ⁻¹
	от 0 до 298	1	5	мг/м ³
Формальдегид CH ₂ O	от 0 до 10	2	6	млн ⁻¹
	от 0 до 13	2	8	мг/м ³

Инфракрасные датчики (ИКД)

Сумма углеводородов C ₁ -C ₁₀ (поверочный компонент: CH ₄)	от 0 до 100	10	20	% НКПР
	от 0 до 4,40	0,44	0,88	% об.д.
Метан CH ₄	от 0 до 100	10	20	% об.д.
Сумма углеводородов C ₁ -C ₁₀ (поверочный компонент: C ₃ H ₈)	от 0 до 100	10	20	% НКПР
	от 0 до 1,70	0,17	0,34	% об.д.
Диоксид углерода CO ₂	от 0 до 5,0	0,9	1,5	% об.д.
	от 0 до 10,0	0,9	1,5	% об.д.

Фотоионизационные датчики (ФИД)

Сумма углеводородов C ₃ -C ₁₀ (поверочный компонент: i-C ₄ H ₈)	от 0 до 4000	100	1000	мг/м ³
Сумма углеводородов C ₃ -C ₁₀ (поверочный компонент: C ₆ H ₁₄)	от 0 до 4000	300	1610	мг/м ³
Изобутилен i-C ₄ H ₈	от 0 до 4000	100	1000	мг/м ³
Гексан C ₆ H ₁₄	от 0 до 4000	300	1610	мг/м ³
Углеводороды нефти C _x H _y (поверочный компонент: i-C ₄ H ₈)	от 0 до 4000	300	2100	мг/м ³
Пары бензина (поверочный компонент: i-C ₄ H ₈)	от 0 до 4000	100	1630	мг/м ³
Пары керосина (поверочный компонент: i-C ₄ H ₈)	от 0 до 4000	300	2100	мг/м ³
Пары дизельного топлива (поверочный компонент: i-C ₄ H ₈)	от 0 до 4000	300	3460	мг/м ³
Метанол CH ₃ OH	от 0 до 4000	5	15	мг/м ³